


## MDR-konform, leistungsfähig, zuverlässig: Produkte für die maschinelle Aufbereitung

Die Aufbereitung von maschinell aufbereitbaren Medizinprodukten in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten braucht verlässliche Produkte. Die Produkte neodisher® MediClean Dental, neodisher® Z Dental und neodisher® MediKlar Dental sind selbst Medizinprodukte entsprechend der europäischen Medizinprodukteverordnung (Verordnung [EU] 2017/745). Die Produkte wurden vom Hersteller in internen und externen Laboratorien unter Praxisbedingungen umfangreich geprüft sowie ihre ausgeübte Leistungsfähigkeit, Materialverträglichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit bestätigt. Außerdem sind die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen mit umfangreichen technischen Dokumentationen nachgewiesen. Die Konformitätsbewertungen sind positiv abgeschlossen, sodass die Produkte herstellerseitig mit CE gekennzeichnet werden dürfen. Die genannten Produkte sind seit vielen Jahren erfolgreich im Markt etabliert und werden u. a. von zahlreichen Medizinprodukteherstellern für die Reinigungsvalidierung ihrer aufbereitbaren Medizinprodukte eingesetzt. Aus der Marktüberwachung sind keine anderen oder nachteiligen Informationen bekannt, die den bestimmungsgemäßen Gebrauch dieser Produkte einschränken.

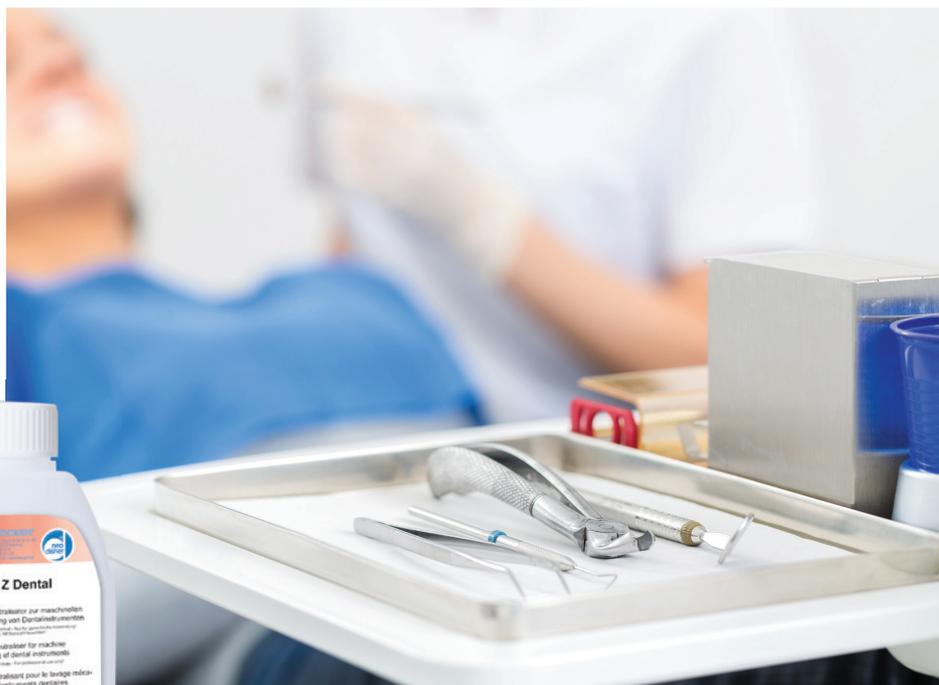

### FÜR DEN FALL DER FÄLLE ...

Sollte bei ordnungsgemäßer Produkthanwendung dennoch ein Schaden am Reinigungs- und Desinfektionsgerät nachweislich auf einen Fehler der eingesetzten Produkte zurückzuführen sein, steht der Hersteller für diese Schäden ein. Damit sind Praxisinhaber abgesichert. Eine anwenderbezogene, individuelle Haftungserklärung kann auf Anfrage gerne ausgestellt werden.

**Achtung:** Nicht eingeschlossen sind entsprechende Verschleißteile, die regelmäßig erneuert werden müssen.

### Sicherheit für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten

Der Hersteller versichert zudem, dass die vorgestellten Produkte für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Instrumente geeignet sind. Ferner wird bestätigt, dass bei deren fachgerechter Anwendung die Medizinprodukte sowie das Reinigungs- und Desinfektionsgerät durch den Aufbereitungsvorgang keinen Schaden nehmen, der auf die genannten Produkte zurückzuführen ist. Die aufzubereitenden Medizinprodukte müssen vom Hersteller als geeignet für die maschinelle Aufbereitung ausgewiesen sein. Voraussetzung ist die bestimmungsgemäße Anwendung unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisungen der aufzubereitenden Medizinprodukte, des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes und unserer Produktinformationen.

Dies schließt die Produkte neodisher® MediClean Dental, neodisher® Z Dental und neodisher® MediKlar Dental für die Verwendung in handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, wie z. B. der Hersteller Miele oder MELAG, ein.