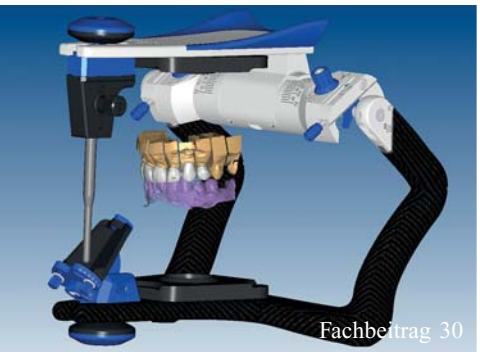

Fachbeitrag 30


Fachbeitrag 33


© Khakimullin Aleksandr
Information 42

Editorial

03 Die „digitale“ Technik braucht „analoge“ Grundlagen
_Dr. med. Frank Schaefer

Fachbeiträge

06 3-D-Anwendungen in der Zahnheilkunde
_Prof. Dr. Walter Schmitt

10 „Vollzirkon“ – eine prospektive Versorgung? ZrO_2-Monolithen für verblendfreie Kronen und Brücken
_Manfred Kern

14 Funktion und Ästhetik – Implantologie mittels CAD/CAM
_Dr. Erhard Reichelt

20 Digitale Techniken für eine effektive Bohrschablonenherstellung
_Dr. Jörg Neugebauer, Dr. Frank Kistler, Dr. Steffen Kistler, Dr. Lutz Ritter, Dr. Timo Dreiseidler, Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller

26 Ändert CAD/CAM das Praxis-Labor-Verhältnis?
_ZA/ZT Peter Neumeier

30 Möglichkeiten des interdisziplinären Workflows
_Dr. Christoph Pape, Guido W. Hammen

32 Chairside Oral Scanner Lava™ – Randschluss überzeugt selbst Skeptiker!
_Dr. Christian Pieper

36 Moderne Diagnostik im Test – Erfahrungen mit Pan eXam plus, KaVo
_Priv.-Doz. Dr. Margrit-Ann Geibel

Information

40 Neupatienten-Management über das Internet
_Dr. Michael Visse

42 Viele Ärzte tappen in die Facebook-Falle
_Michaela Hermes, LL.M. (Medizinrecht), Rechtsanwältin

38 **News**

45 **Herstellerinformation**

50 **Impressum**

Alle mit Symbolen gekennzeichneten Beiträge sind in der E-Paper-Version der jeweiligen Publikation auf **www.zwp-online.info** mit weiterführenden Informationen vernetzt.







e.max®
IPS

DIE WELT SPRICHT e.max.



DIE WISSENSCHAFT* EBENSO.

BIS ZU 10 JAHRE[1] KLINISCHE BESTÄTIGUNG.
98,2 %[2] ÜBERLEBENSRATE BEI KRONEN.
40 MIO. RESTAURATIONEN.[3]
1 BEWÄHRTES VOLLKERAMIK-SYSTEM: IPS e.max



Multilink® Automix
Das adhäsive Befestigungs-System. Millionenfach verwendet.
Für alle IPS e.max-Restaurationen.

* Der IPS e.max Scientific Report Vol. 01 (2001–2011) ist jetzt verfügbar unter: www.ivoclarvivadent.com/science_d

[1] M. Kern et al. "Ten-year results of three-unit bridges made of monolithic lithium disilicate ceramic"; Journal of the American Dental Association; März 2012; 143(3):234-240.
[2] Durchschnittlicher Beobachtungszeitraum 4 Jahre bei IPS e.max Press, 2,5 Jahre bei IPS e.max CAD. Siehe IPS e.max Scientific Report Vol. 01 (2001–2011).
[3] Basierend auf Verkaufsmengen.

www.ivoclarvivadent.de

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2 | 73479 Ellwangen, Jagst | Deutschland | Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0 | Fax +49 (0) 79 61 / 63 26

ivoclar vivadent®
passion vision innovation