

**KN Fortsetzung von Seite 1**  
*Laborgefertigte Positionierungsschablone*

Die Gegenüberstellung der direkten und indirekten Bracketbefestigung macht gesamthaft Vorteile der indirekten Befestigung deutlich. Dabei stehen die geringere Behandlungszeit und die geringeren Positionierungsfehler im Vordergrund. Allerdings sind die zahntechnischen Mehrkosten in Kauf zu nehmen.

**Direktes Kleben mit einer Positionierungsschablone**

Als Kombination der beiden Klebmethoden kann das direkte Kleben mit einer laborgefertigten Positionierungsschablone definiert werden. Das Vorgehen ist zwar immer noch zweizeitig, die zusätzlichen Laborkosten fallen allerdings wesentlich geringer aus. Zudem kann eine erhebliche

Direktes Kleben	
<b>Vorteile</b>	<b>Nachteile</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• geringer Materialaufwand</li> <li>• kein Verpressen von Komposit in den Approximalraum</li> <li>• einzeitiges Vorgehen</li> <li>• kostengünstiger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• längere Behandlungszeit</li> <li>• schlechte Sicht auf die distalen Zähne</li> <li>• tendenziell mehr Positionierungsfehler</li> <li>• anspruchsvolle Lernkurve beim Umgang mit den Messlehren</li> <li>• Messlehren erlauben in der Regel die Einstellung nur einer Distanz (Slot-Inzisalkante)</li> </ul>

Zeiterparnis bei gleichzeitig sehr genauer Positionierung der Brackets beobachtet werden. Das direkte Kleben mit einer laborgefertigten Positionierungsschablone mindert gewissermaßen die Nachteile des direkten und indirekten Klebens und schiebt vermehrt deren Vorteile in den Vordergrund.

Ohne Einsatz moderner Computerprogramme und Fertigungstechnologien liegt die Herstellung einer Positionierungsschablone allerdings weit im Bereich der Ineffizienz. Für die manuelle Fertigung einer Positionierungsschablone ist mit etwa gleichem

Aufwand zu rechnen wie für die Fertigung einer Übertragungsschablone. Erfolgt aber die Positionierung virtueller Brackets auf das virtuelle Modell am Bildschirm, erübrigen sich alle beschriebenen Arbeiten am Gipsmodell. Am Bildschirm kann nach der virtuellen Bracketpositionierung über die gesamte Situation eine virtuelle Übertragungsschablone als eigenständige STL-Datei gelegt werden, bei welcher die Zone der Bracketbasis als Fenster ausgespart bleibt. Die Einstellungsparameter der Bracketpositionierung erfolgen nach den Angaben des

Indirektes Kleben	
<b>Vorteile</b>	<b>Nachteile</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verringerung des Abstandes zwischen Bracketbasis und Zahnoberfläche</li> <li>• optimale Sicht auf das Situationsmodell bei der Bracketpositionierung</li> <li>• kurze Behandlungszeit</li> <li>• geringere Positionierungsfehler gegenüber dem direkten Kleben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• erhebliche zusätzliche Laborkosten<sup>1</sup></li> <li>• zweizeitiges Vorgehen</li> <li>• mögliche Ungenauigkeiten bei der Modellherstellung</li> <li>• Gefahr des Verpressens von Komposit in den Approximalraum</li> </ul>

Herstellers und können natürlich in jeder Hinsicht individuellen Behandlerwünschen angepasst werden.

Die virtuelle Schablone wird mittels 3D-Drucktechnik physisch hergestellt und in situ auf den Zahnkranz gelegt. Die Klebung der Brackets erfolgt direkt, indem der Behandler die Brackets in die Bracketfensterchen der Übertragungsschablone einsetzt.

Nachfolgend soll das Vorgehen einer solchen Bracketklebung mit der Dokumentation eines Praxisfalls beschrieben und erörtert werden.

**Klinisches Fallbeispiel**

**Befund und Planung**

Die Profilanalyse beim 15-jährigen Patienten zeigt ein schräg rückwärts gerichtetes Durchschnittsgesicht (Profilwinkel 19,2°, Norm 10° ± 2,0°). Die Zähne sind kariesfrei und verzahnen in Klasse I. Im Unterkiefer besteht ein starker Engstand in der Front (-10,7 mm) kombiniert mit einem dentalen und skelettalen Tiefbiss (Overbite 7,0 mm / Overjet 4,0 mm). Die relevanten Werte aus Kephalemetrie und Modellanalyse (Abb. 4 und 5) sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Der Platzbedarf von 10,0 mm für die Einreihung der Eckzähne im Unterkiefer ist erheblich, aber kieferorthopädisch mit einigem Aufwand kompensierbar. Als Platzbeschaffung kommen die folgenden Positionen infrage:

- Mit der Erhöhung von Protrusion (+2,0 mm) und Proklination (+2,0°) der UK-Front ergibt sich ein Platzgewinn von etwa 6,0 mm.
- Diese Erhöhung ist allerdings nur bei gleichzeitiger Bisshebung von etwa 2,0 mm möglich.
- Mit einer interproximalen Reduktion (IPR) von mesial 34 bis mesial 44 ergeben sich 14 Reduktionsmöglichkeiten à 0,3 mm, was einem Platzgewinn von 4,2 mm entspricht.

Therapeutisch sind hierfür im Oberkiefer und Unterkiefer festsetzende Apparaturen indiziert. Es sollen SPEED-Brackets (Fa. Strite Industries) mittels einer Positionierungsschablone direkt eingegliedert werden. Auf eine differenzierte Zusammenstellung der einzelnen Therapieschritte und deren zeitliche Abfolge wird im vorliegenden Bericht über die direkte Klebung von Brackets mithilfe einer laborgefertigten Schablone verzichtet.

**Herstellung der Schablone**

Die Herstellung der Schablone erfolgt in zwei Schritten. Als Bildschirmarbeit steht vorerst die Positionierung der Brackets und die Gestaltung der Schablone an. Die im STL-Format vorliegende Schablone wird anschließend im 3D-Druckverfahren physisch hergestellt.

**Bildschirmarbeit**

Am Bildschirm werden die virtuellen Brackets auf die Zahnreihe positioniert. Grundsätzlich kann jedes Bracketsystem zum Einsatz kommen. Voraussetzung ist die Generierung eines virtuellen Datensatzes der Brackets im STL-



Abb. 1a, b

Abb. 2a-e

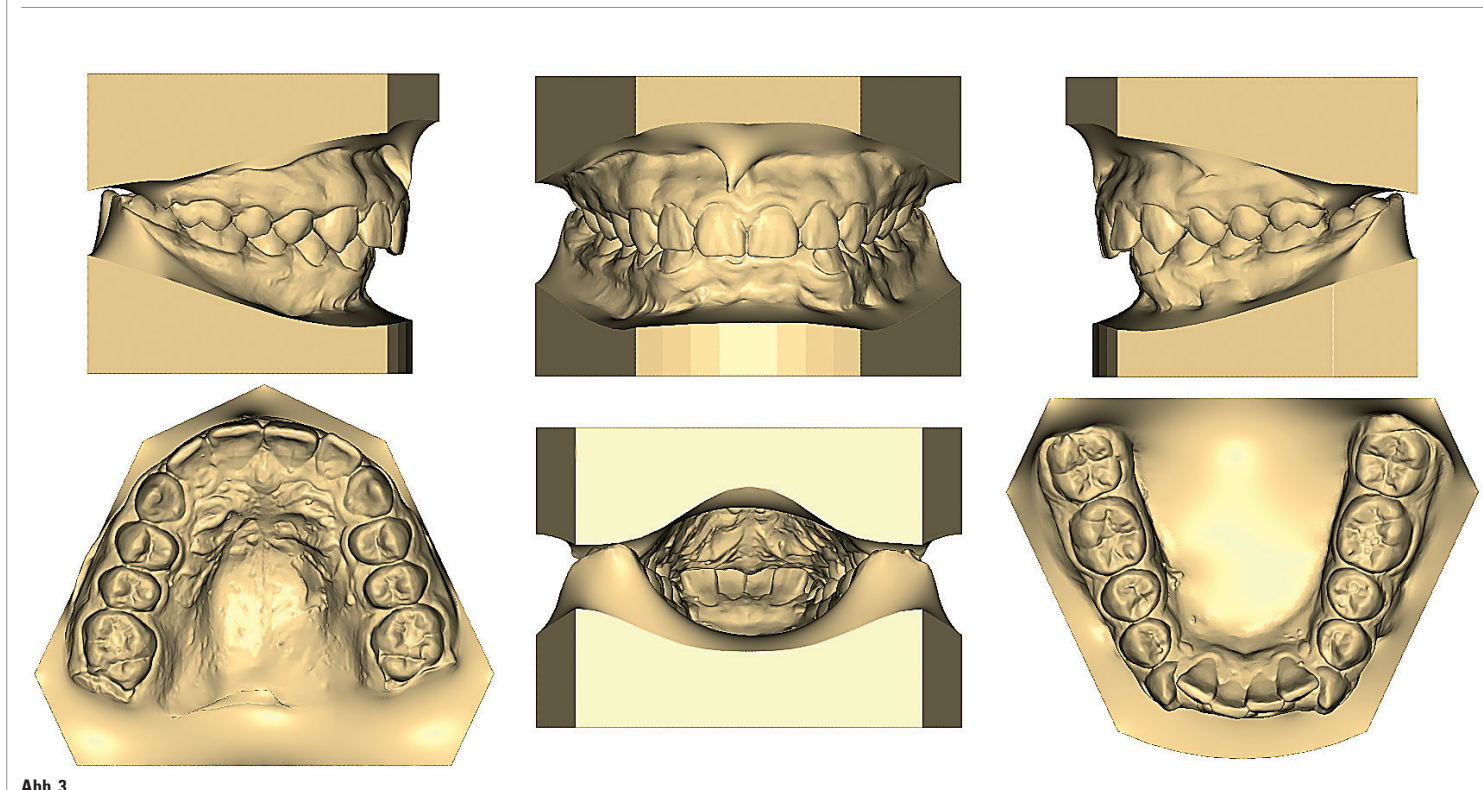


Abb. 3





**3M™ Clarity™ Advanced  
Keramikbracket.  
Unser Meisterstück.**

Besuchen Sie uns  
auf der **DGKFO** in Bonn,  
am **Stand D02**



**APC Flash Free™  
Adhäsiv-Vorbeschichtung**

Sichere Haftung ohne Überschussentfernung

**Gut planbares Debonding**

Mit einzigartiger Sollbruchstelle

**Brilliante Ästhetik und  
optimaler Tragekomfort**

Stabiles Keramik-Bracket mit flachem Profil

**Stabilität und Design**

Bietet maximale Flexibilität während der Behandlung



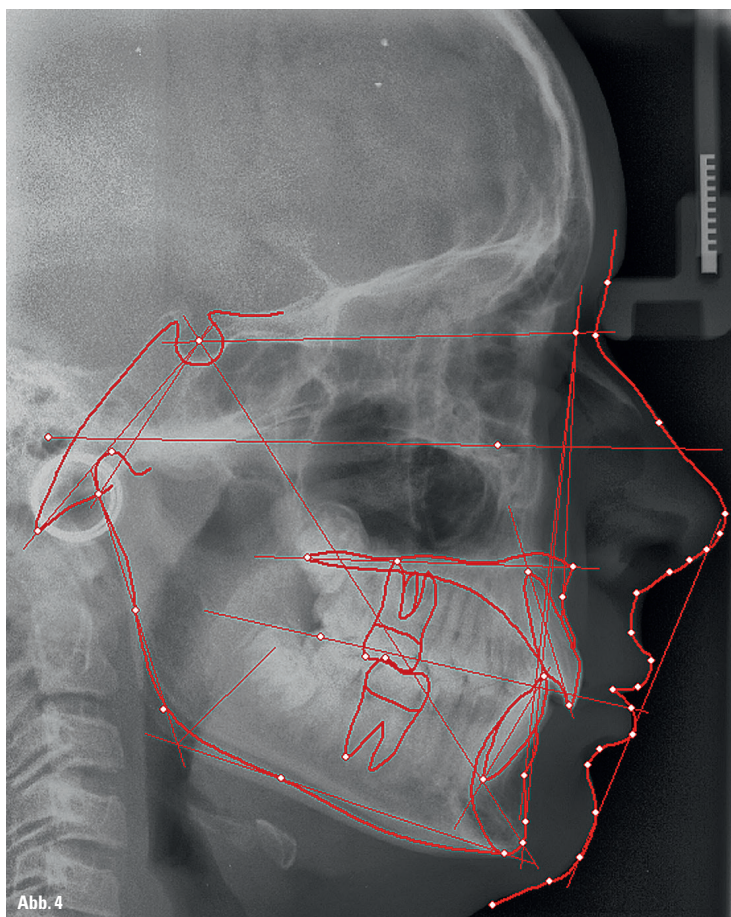


Abb. 4

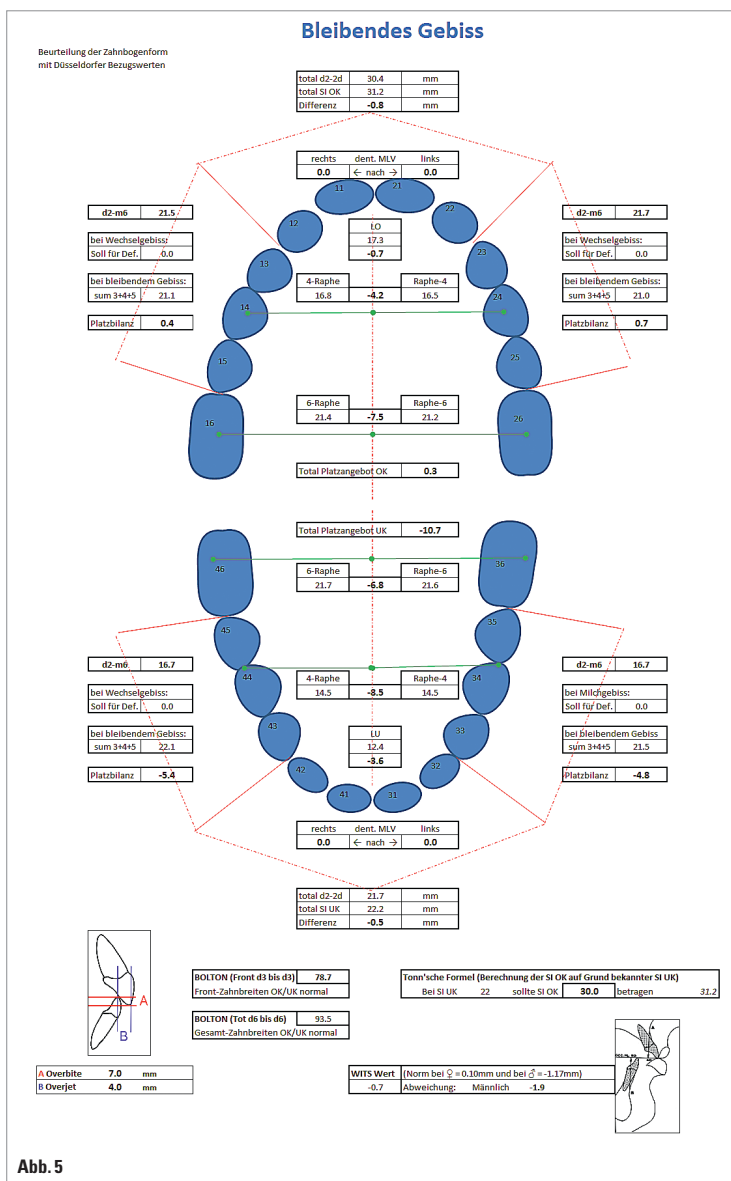


Abb. 5

Analyse	Ist-Wert	Norm	Therapeutischer Aspekt
ANB-Winkel	3,7°	3,0°	bleibt unverändert
WITS-Wert	-1,0 mm	-1,0 mm	bleibt unverändert
Overjet	4,8 mm	2,0 mm	reduzieren (Platzreserve für UK-Front)
Overbite	7,4 mm	2,0 mm	Bisshebung (Platzreserve für UK-Front)
Oberkiefer	Protrusion 2,0 mm	4,0 mm	bleibt unverändert
	Proklination 19°	21°	bleibt unverändert
	Platz d6-6d 73 mm	73 mm	bleibt unverändert
Unterkiefer	Protrusion 1,0 mm	4,0 mm	erhöhen (Platzreserve für UK-Front)
	Proklination 24°	24°	erhöhen (Platzreserve für UK-Front)
<b>Tab. 1</b>	Platz d6-6d 55 mm	65 mm	= Platzbedarf für d3-3d: 10 mm

Fortsetzung von Seite 10

Format. Dieser kann programm-spezifisch bearbeitet und in der Programmbibliothek abgelegt und je nach Bedarf wieder abgerufen werden. Die Position der Brackets auf den Zähnen wird am Bildschirm pauschal vorgeschlagen. Dabei kann voreingestellt werden, nach welcher Positionierungstechnik die Brackets gesetzt werden sollen. Im gezeigten Fall ist die Situation gemäß der MBT-Technik (3M Unitek) eingestellt. Dies entspricht der Platzierung der Brackets so, dass die Zwillingsflügel parallel über der Längsachse der klinischen Krone ausgerichtet sind und der Mittelpunkt der Bracketslots auf der vertikalen Mitte der klinischen Krone liegt. Als vertikales Positionsmaß wird dabei die Distanz zwischen dem Bracketslot zur Schmelzkante eingesetzt. Im gezeigten Fall sind dies 4,0 mm. Individuell kann die Position eines Brackets jederzeit den Wünschen des Behandlers bzw. den individuellen Variationen der Zahnformen entsprechend nachjustiert werden. Solches erfolgt durch die Verschiebung am aktivierten Manipulator des jeweiligen Brackets (Abb. 6). Nach Positionierung der Brackets wird die Umrandung der geplanten Schablone eingezeichnet. Programmgesteuert wird dabei das Fenster, welches die Bracketbasis auf dem Zahn darstellt, automatisch ausgestanzt. Der Rand der Schablone wird so gelegt, dass er durch den zervikalen Rand der Bracketbasis verläuft. Dadurch entsteht anstelle des viereckigen Fensters für die Bracketbasis eine nach zervikal offene Aussparung, in welche vorerst die Bracketbasis eingeschoben werden kann und welche anschließend die einfache Entfernung der Schablone durch Abziehen in okklusaler Richtung ermöglicht (Abb. 7 bis 9).

3D-Druck

Die zahntechnische Fertigung der Schablone erfolgt im 3D-Drucker Asiga MAX™ (Fa. SCHEUDENTAL), wobei das auf Methacrylat basierende Photopolymer IMPRIMO® LC IBT (Fa. SCHEUDENTAL) als Werkstoff zur Anwendung kommt. IBT steht für „Indirect Bonding Tray“ und ist besonders für diese Applikationen geeignet, da es a) transparent ist und somit eine Kontrolle über den Sitz der Brackets ermöglicht und b) auch nach der vollständigen Aushärtung flexibel bleibt, um es nach dem Kleben der Brackets wieder problemlos ausgliedern zu können (Abb. 10 und 11). Der 3D-Drucker Asiga MAX™ zeichnet sich als kompaktes, sehr handliches und besonders für den Einsatz im zahntechnischen/kieferorthopädischen Labor entwickeltes Gerät aus. Die vertikale Auflösung (z-Auflösung) liegt bei 25 bis 100 µm und die laterale Auflösung (xy-Auflösung) liegt bei 62 µm. In der eingebauten Software ist eine Vielzahl an manuellen und automatischen Supportfunktionen eingebaut. Die Bedienung ist sehr nutzerfreundlich gestaltet und die Überwachung des gesamten Bauprozesses erfolgt vom Start bis zum Ende über das integrierte Farb-LCD oder wahlweise am Arbeitsplatz über das eingebaute Webinterface. Beispielsweise ist die Vorbereitung eines Drucks inklusive der Platzierung der Druckobjekte in weniger als fünf Minuten getätigt. Nach dem Datentransfer arbeitet das Gerät selbstständig und braucht keine Computerverbindung mehr. Der Druckprozess für z. B. zwei Transferschablonen gelingt mit dem Asiga MAX™ in nur 30 Minuten. Nach Ablauf des Drucks wird die Bauplatform, an welcher die gefertigten Schablonen haften, aus dem Kunststoffbecken gehoben und es erfolgt die Nachbearbeitung (Abb. 12 und 13). Nicht ausgehärtete Harzrückstände werden mit Isopropanol vom vorpolymerisierten Objekt entfernt. Nach der rückstandslosen Reinigung muss die Scha-

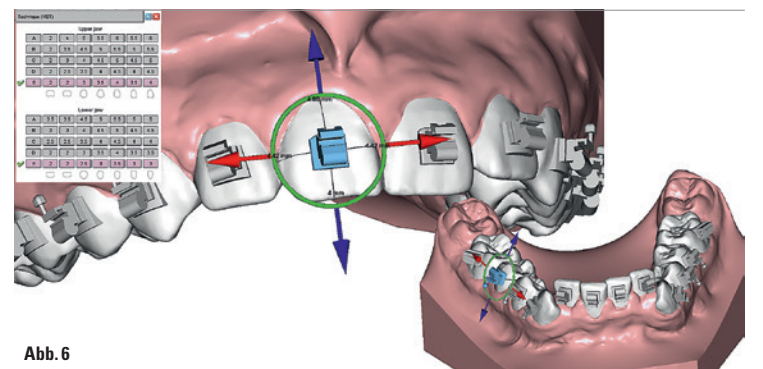


Abb. 6

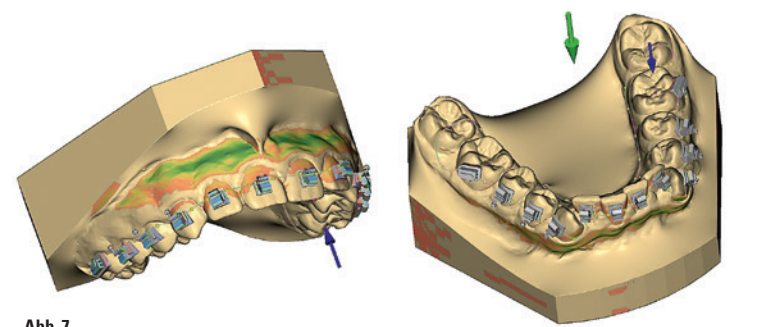


Abb. 7

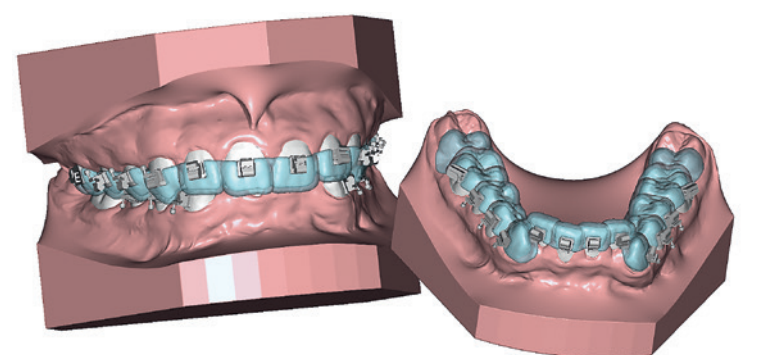


Abb. 8

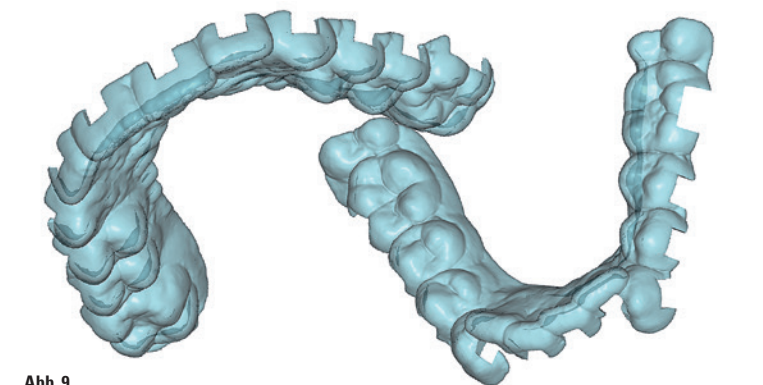


Abb. 9

blone noch final auspolymerisiert werden. Diese Endhärtung sollte in einem markt-gängigen Lichtofen unter Schutzglas geschehen. Abweichungen von dem aufgeführten Herstellungsprozess können zu veränderten mechanischen Eigenschaften oder Farbabweichungen des Materials führen. Mit Anpassungsarbeiten der Schablone auf dem Modell ist nicht zu rechnen, wenn bereits bei der Konstruktion am Bildschirm die automatische Ausblockung von Unterschnitten aktiviert wurde (Abb. 14). Da die Schablonen für die Positionierung von Brackets dienen und da diese Brackets mit polymerisierenden Kompositklebern eingegliedert werden, ist eine geeignete Isolierung der Schablone dringend empfohlen. Die 3D-Modellisolierung aus dem Hause SCHEUDENTAL zeigt gute Ergebnisse. Bereits der ein- bis zweimalige Auftrag mit dem beiliegenden Pinsel ergibt eine optimale Isolierwirkung von Acrylat gegen Acrylat (Abb. 15).

len und automatischen Supportfunktionen eingebaut. Die Bedienung ist sehr nutzerfreundlich gestaltet und die Überwachung des gesamten Bauprozesses erfolgt vom Start bis zum Ende über das integrierte Farb-LCD oder wahlweise am Arbeitsplatz über das eingebaute Webinterface. Beispielsweise ist die Vorbereitung eines Drucks inklusive der Platzierung der Druckobjekte in weniger als fünf Minuten getätigt. Nach dem Datentransfer arbeitet das Gerät selbstständig und braucht keine Computerverbindung mehr. Der Druckprozess für z. B. zwei Transferschablonen gelingt mit dem Asiga MAX™ in nur 30 Minuten. Nach Ablauf des Drucks wird die Bauplatform, an welcher die gefertigten Schablonen haften, aus dem Kunststoffbecken gehoben und es erfolgt die Nachbearbeitung (Abb. 12 und 13). Nicht ausgehärtete Harzrückstände werden mit Isopropanol vom vorpolymerisierten Objekt entfernt. Nach der rückstandslosen Reinigung muss die Scha-



DGKFO 2017  
Stand D01



Echte Präzision erreicht man nur,  
wenn man sein Handwerk versteht.

Wie wir seit 110 Jahren.

*Die Verbindung von Ästhetik und Feinmechanik begann  
bei uns mit der Fertigung von Schmuck und Uhren.  
Heute zaubert sie mit unseren Brackets den Menschen  
ein Lächeln ins Gesicht.*



**FORESTADENT**<sup>®</sup>  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS





Abb. 10

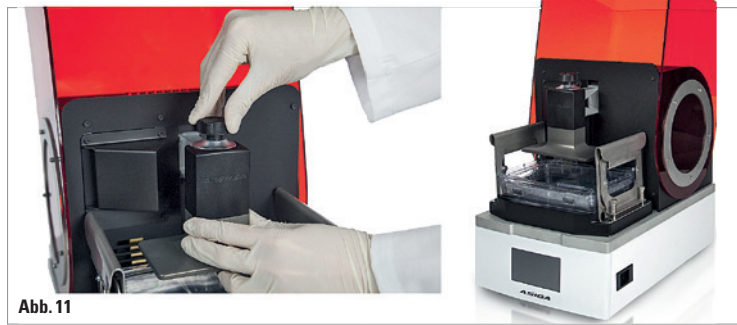


Abb. 11

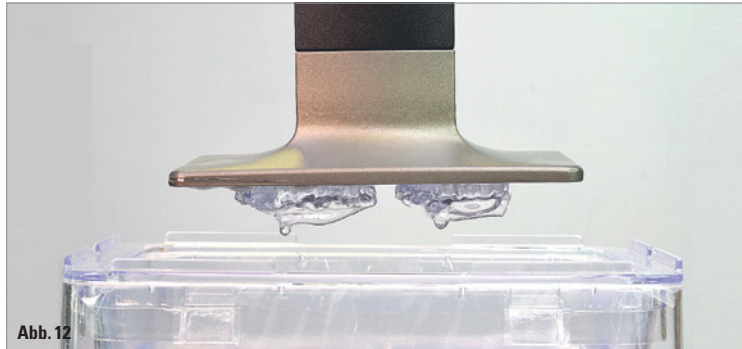


Abb. 12



Abb. 13



Abb. 14



Abb. 15

**Materialien, Geräte, Programme**

- Link zur Zusammenstellung von Softwares für das Dentallabor: <http://www.medicalexpo.de/medizin-hersteller/software-dentallabor-16440.html>
- Eingesetzte Software: Maestro 3D, Ortho Studio (orthodontisches Modul), Version 4
- 3D-Drucker: Asiga MAX™, SCHEU-DENTAL
- Drucker-Harz: IMPRIMO® LC IBT, SCHEU-DENTAL
- Endhärtung: LC-6 Light Oven, SCHEU-DENTAL
- Isolierung: 3D-Modellisolierung, SCHEU-DENTAL
- Bracketsystem: SPEED-Brackets, Strite Industries
- Adhäsive Bracketklebung: GC Fuji Ortho LC, lighthärtender Glasionomerzement

**KN Kurzvita**



**Dr. Monika Baltzer**  
[Autoreninfo]



**Dr. Andres Baltzer**  
[Autoreninfo]



**ZTLM Vanik Kaufmann-Jinoian**  
[Autoreninfo]



**KN Fortsetzung von Seite 12**

**Klebeprozess in situ**

Bei den aus glasklarem Kunststoff gedruckten Schablonen sind die prozesstechnisch angebrachten Unterstü- tungen etwas dicker gestaltet und werden nach dem 3D-Druck nicht entfernt. Den lediglich 1,0 mm dicken Schablonen ist somit eine gute Stabilität verliehen. Die Anprobe in situ zeigt eine einwandfreie Passung (Abb. 16a, b).

Nach gründlicher Reinigung und Anätzung der bukkalen Zahnflächen im Bereich der Bracketklebung erfolgt die Trockenlegung der Mundhöhle und Ein-

gliederung der Schablone. Da im Rahmen der Konstruktion der Schablonen Unterschnittbereiche minimal auf 0,1 mm gestellt wurden, weist die Schablone in situ genügend Retention auf und muss nicht speziell gehalten oder befestigt werden. Der Behandler kann sich somit unbeschwert auf die Platzierung der Brackets konzentrieren. Diese bleibt auch visuell recht gut kontrollierbar durch das glasklare Schablonenmaterial.

Die Basis des Brackets wird wie bei allen anderen Klebetechniken sehr sparsam mit einem Tropfen Kleber belegt, um

Überschüsse oder gar Zementverpressungen in die Approximalzonen zu verhindern. Kleberwahl im gezeigten Fall: GC Fuji Ortho LC. Nach Anpassung erfolgt die routinemäßige Lichthärtung (Abb. 17 bis 19).

Nach der Lichthärtung des Klebers wird die Schablone durch Zug in okklusaler Richtung entfernt. Die Flexibilität des IMPRIMO®

LC IBT-Materials erleichtert das Entfernen der Schablone erheblich. Die kieferorthopädische Behandlung kann nun mit der Einligierung des ersten Bogens beginnen (Abb. 20a, b).



**Zusammenfassung**

Die vorgestellte Methode für die direkte Klebung von Brackets mithilfe einer Positionierungsschablone vereinfacht den eigentlich sehr anspruchsvollen Arbeitsprozess. Das System ist für jeden Behandler individuell anpassbar. Wer über die notwendige Soft- und Hardware verfügt, kann seine Schablone selbst generieren. Vorstellbar ist aber auch, das Design der Schablone in Auftrag zu geben und den 3D-Druck selbst zu bewerkstelligen. Oder umgekehrt. Da die Schablone aus durchsichtigem Kunstharz besteht, ist die direkte Positionskontrolle am natürlichen Zahn stets ermöglicht.

Die Genauigkeit der Position der Brackets entspricht mindestens jener der indirekten Klebemethode, wobei allerdings wesentlich geringere Vorbereitungs- und Laborkosten anfallen. Die Zeitersparnis im Vergleich zur direkten Klebung mit visueller Positionierung auf Augenmaß ist in Anbetracht des durchschnittlichen Zeitaufwands von zehn Minuten pro Kiefer recht erheblich. **KN**

<sup>1</sup> Zahntechnik für indirektes Kleben: 1. Vorbereitung (Zahnachsen und Kronenkontur einzeichnen). 2. Bracket auf Modell kleben (Modell isolieren, Bracketbasis sandstrahlen und mit Aceton reinigen, Kleber auf Modell und auf Bracketbasis auftragen, Bracket positionieren und Überschüsse entfernen, Aushärten mit Licht). 3. Übertragungsschiene (Ausblocken der Brackets mit Xantopren, Modell isolieren, Silikonmasse auftragen, 30 Minuten im Drucktopf aushärten). 4. Ablösen der Schiene (Schiene 60 Minuten in heißes Wasser legen, mit Skalpell ausarbeiten, Entlastungsschnitte einbringen, Bracketbasis sandstrahlen).



**KN Adresse**

**Dres. Andres und Monika Baltzer**  
Gartenweg 12  
4310 Rheinfelden  
Schweiz  
Tel.: +41 61 8369090  
Fax: +41 61 8314077  
Andres@baltzer.ch

**ZTLM Vanik Kaufmann-Jinoian**  
Cera-Tech AG  
Poststr. 13  
4410 Liestal  
Schweiz  
Vjinoian@aol.com



dental  
bauer



# Profitieren Sie vom Messeherbst!

Erleben Sie die Produkte live auf der **DGKFO in Bonn**.  
Besuchen Sie uns auf dem  
**ULTRADENT-Stand A09, Foyer Rheinebene**

**Individualisieren  
Sie sich Ihren  
KFO-Arbeitsplatz mit  
dental bauer!**

Sichern Sie sich bis zu

**20%**  
**Rabatt**



**DÜRR  
DENTAL**

## VistaPano S Ceph – rundherum perfekt im Bild

### Die perfekte Verbindung von Bildqualität, Effizienz und Design

Seine herausragende Abbildungsleistung verdankt das **VistaPano S Ceph** der modernen **CSI-Sensortechnologie** sowie der **S-Pan-Technologie**; sie nutzt die Bildinformation der individuellen Patientenaufnahme, um an jeder räumlichen Position der Zahn- und Kiefersituation automatisch eine **gestochen scharfe Panoramadarstellung** zu präsentieren.



**ULTRADENT**  
DENTAL UNITS. MADE IN GERMANY.

## Der dental bauer blue line-Behandlungsplatz

### Das kompakte Allround-Talent aus deutscher Fertigung

Der speziell auf die Bedürfnisse und Arbeitsweisen von Zahnärzten und Kieferorthopäden zugeschnittene **blue line-Behandlungsplatz** von dental bauer und Ultradent punktet mit einer Reihe von Premium-Merkmalen, die kieferorthopädische Behandlungen individuell, flexibel und ausdauernd unterstützen – bei maximaler Effizienz.

**Eine starke Kombination für die Kieferorthopädie zu unschlagbaren  
Messepreisen.**

**Sie haben Interesse und wünschen ein individuelles Angebot? Dann sprechen Sie uns bitte an!  
Sie finden uns bundesweit an über 20 Standorten.**

dental bauer GmbH & Co. KG; Sitz: Tübingen; Registergericht: Amtsgericht Stuttgart (HRA 380 243); Ust-IdNr. (Deutschland) DE146889955  
Persönlich haftende Gesellschafterin: dental bauer Verwaltungs GmbH; Sitz: Tübingen; Registergericht: Amtsgericht Stuttgart (HRB 380 779);  
Geschäftsführer: Jochen G. Linneweh, Jörg Linneweh, Heiko Wichmann  
Firmenbuchgericht, Firmenbuchnummer und UID-Nr. der österreichischen Zweigniederlassung: Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (FN 302530 y);  
UID-Nr. (Österreich) ATU63772778

**Hotline**  
**0800 1814949**  
bundesweit zum Nulltarif

**www.  
dentalbauer.de**