

ENDODONTIE

Journal

4₂₀₂₀

Fachbeitrag

Revisionsbehandlung eines Molaren mit komplexer Anatomie

Seite 6

Anwenderbericht

Geschichte und Verwendung von Mineral-Trioxid-Aggregat

Seite 22

Praxismanagement

Jahresgespräche – Unsinn oder wertvolle Zeit für beide Seiten?


Seite 26

Recht

Missbräuchliche Abmahnungen erschwert

Seite 38



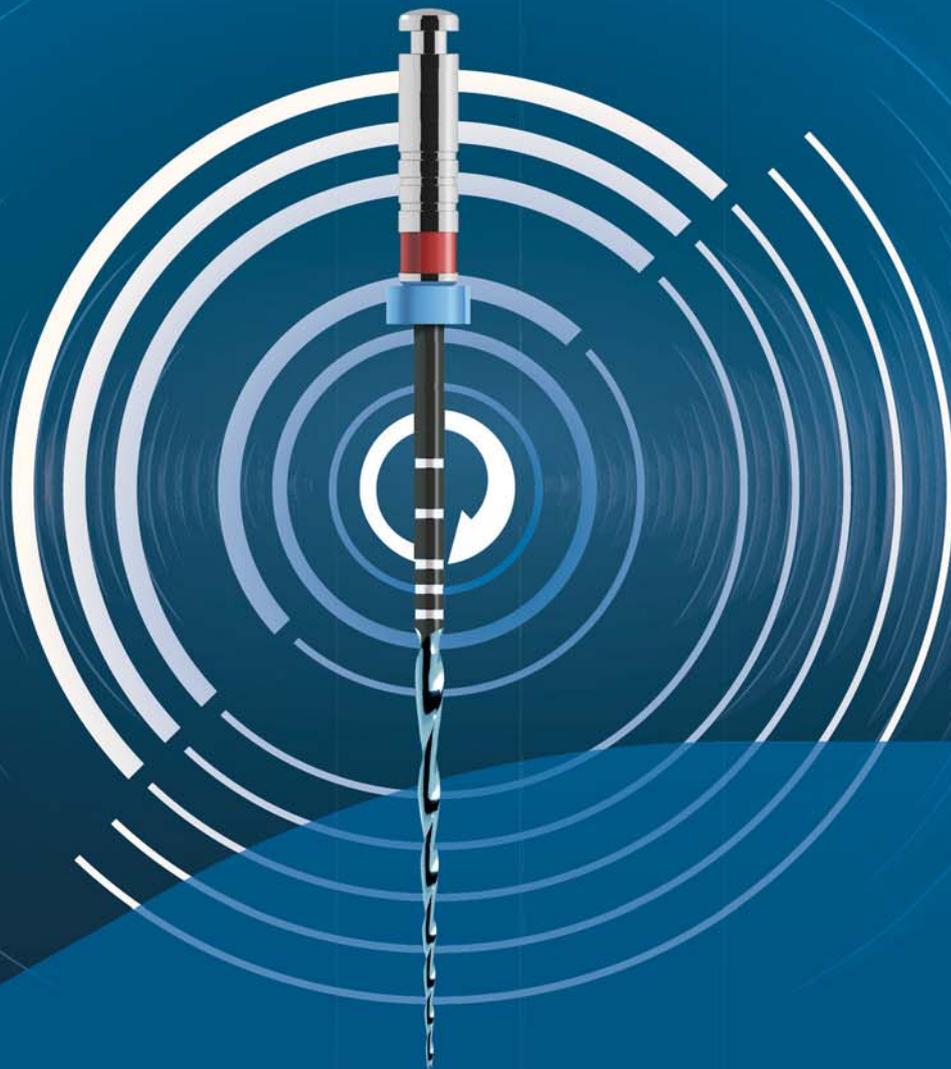

VDW.ROTATE™ NiTi Wurzelkanalfeile

Der Remix für rotierende
Aufbereitung auf
dem nächsten Level

VIELSEITIGKEIT

VDW.ROTATE™ umfasst eine intuitive 3-Feilen-Basissequenz sowie eine große Auswahl an größeren Feilen mit passenden Papierspitzen und Obturatoren.

Damit bereiten Sie virtuos auf!

ERHALT DER NATÜRLICHEN KANALANATOMIE

Dank der speziellen Wärmebehandlung ist die Feile flexibler und folgt so dem natürlichen Kanalverlauf – ohne die Schneidleistung zu beeinträchtigen.*

So bringen Sie Schwung in die
Aufbereitung!

EFFIZIENTES ENTFERNEN VON DEBRIS

Der angepasste S-Querschnitt schafft mehr Raum für den Abtransport von Debris, sorgt für Kontrolle über das Instrument und ermöglicht eine schnelle, gründliche und sichere Aufbereitung.**

Denn Sie geben den Takt an!